



Y-Kabel (Mono-Klinke --> Stereo-Klinke)

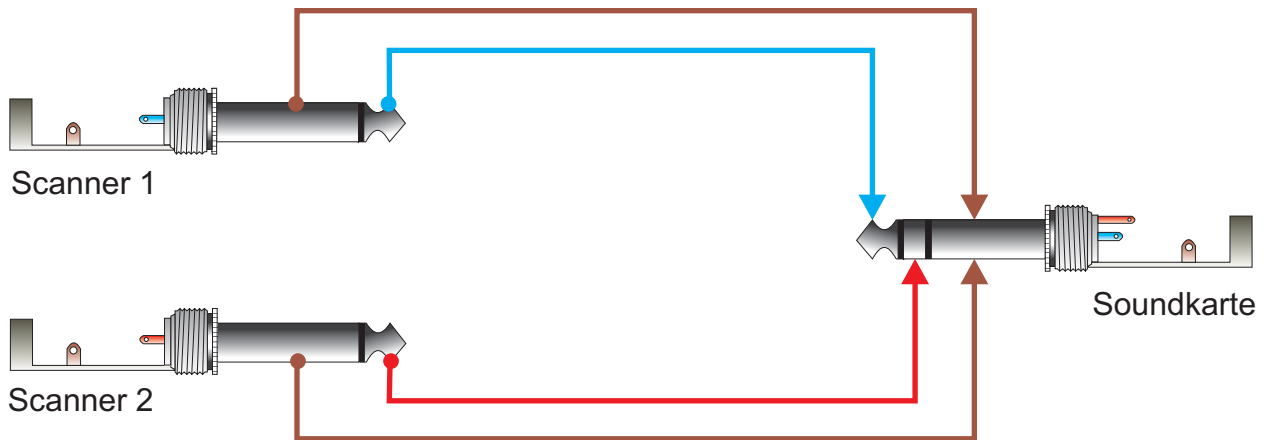

Y-Kabel (Stereo-Klinke --> Stereo-Klinke)*

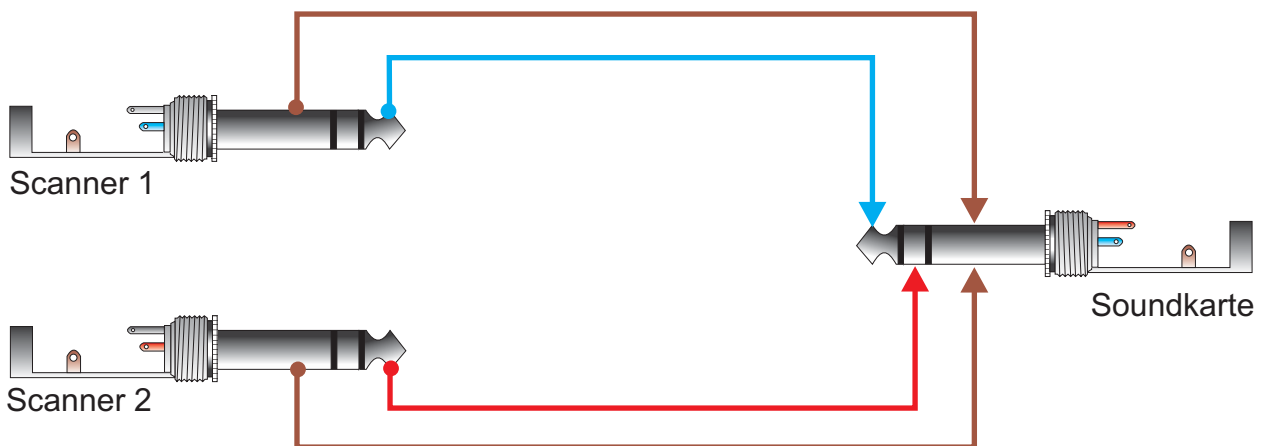

* unter der Voraussetzung, dass Scanner Mono-Klinken-Ausgang hat!